

**19-20-21  
SEPT. 2018**

**PALAIS DU PHARO - MARSEILLE**

## ÉVALUATION DES DEMANDES DE STÉRILISATION EN URGENCE PAR LE BLOC OPÉRATEUR



**C. Goulas, V. Pioud, C. Blondin**  
CH Bassin de Thau - Sète (France)

**PO 18**

### CONTEXTE:

Observation par le service de stérilisation de demandes récurrentes par le bloc opératoire (BO) de stérilisation de matériel en urgence.

### OBJECTIFS:


- En évaluer
- le nombre,
  - les caractéristiques,
  - la pertinence.

### MATÉRIEL & MÉTHODE:

- Étude prospective
- 12 semaines
- Fiche de recueil par demande urgente avec les items:
  - **Caractéristiques de la demande:**
    - Moyen de contact de la stérilisation,
    - Identification du matériel,
    - Délais de rendu souhaité,
    - Justification de la demande,
  - **Caractéristiques du traitement du matériel:**
    - Délais effectif de rendu,
    - Moyens dédiés,
  - **Suivi de l'utilisation du matériel.**


### RESULTATS: N = 24 demandes urgentes

#### SPÉCIALITÉS DEMANDEUSES DE STÉRILISATION EN URGENCE




- Chirurgie orthopédique
- Urologie
- Gynécologie - Obstétrique
- Divers

#### NATURE DES DEMANDES URGENTES

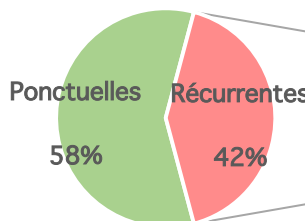


- Ancillaire canal carpien 17%
- Matériel arthroscopie épaule 12%
- Kits sonde JJ 13%


#### JUSTIFICATION DU CARACTÈRE URGENT

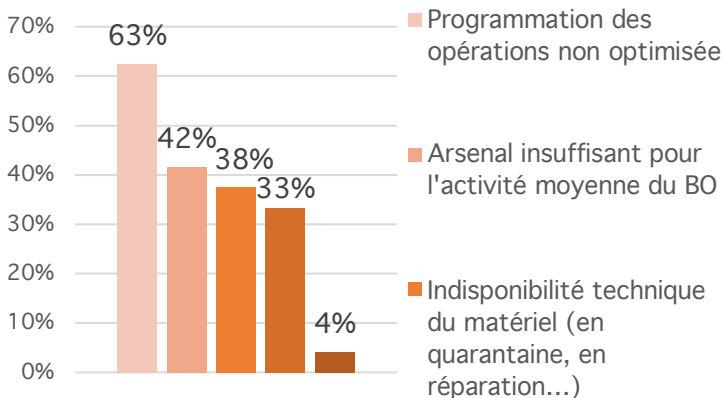

#### Délais de rendu souhaité irréalisable techniquement




#### Matériel rendu avant le début de l'opération



#### Matériel utilisé dans les 24h



#### Nécessité d'une charge dédiée

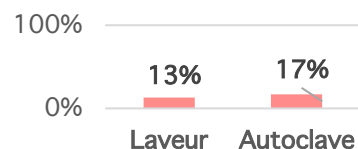

### DISCUSSION:

- Les demandes urgentes sont **régulières** = 2 par semaine
- **Spécialités ayant le plus d'activité** au BO = les plus demandeuses de stérilisation en urgence
- **Le matériel pour lequel un arsenal insuffisant est identifié correspond aux demandes urgentes récurrentes**
- Environ 2/3 des demandes urgentes = **programmation non optimisée en fonction de l'arsenal disponible** → **Demandes urgentes évitables**
- Environ 1/2 des demandes urgentes **sont effectuées trop tard pour que les délais de rendu souhaités puissent être respectés** → **Circuit des demandes urgentes non optimal**  
 NOTA BENE: Si la stérilisation n'est pas prévenue à temps = Nombre de matériel rendu hors délais multiplié par 1,67
- Environ 1/8 du matériel demandé en urgence = **non utilisé dans les 24h** → **Pertinence de l'urgence?**

### CONCLUSION: Mesures correctrices envisagées

- Rédaction d'une **procédure de demande de stérilisation de matériel en urgence**
  - Uniformiser et optimiser le circuit & Éviter la perte de temps et d'informations
- **Présence d'un personnel du service de stérilisation dans la cellule de programmation du BO**
  - Analyse de la programmation des opérations en fonction du matériel disponible → Eviter certaines demandes urgentes & anticiper les besoins pour organiser le travail du service
- **Achat de jeux supplémentaires de matériel pour certaines opérations**