



DM à relaver : que faire? Quel circuit?

E. Grandeau, F. Guilmin, M. Leszczynski, I. Caillier, S. Authier

CH Boulogne sur mer, service pharmacie/stérilisation, rue Jacques Monod- BP 609- 62321 BOULOGNE SUR MER

Objectifs


- *Evaluation nombre de DM à relaver, mode de traitement, traçabilité de l'étape
- *Harmonisation des pratiques

Matériel et méthodes

*création fiche « DM à relaver »


DM A RELAYER					
Partie à remplir par le conditionnement					
DATE:	HEURE:		SIGNATURE:		
<input type="checkbox"/> Sortie lavage	<input type="checkbox"/> Recompo	<input type="checkbox"/> Sortie autoclave			
Nom de la boîte:	Non-conformité(s) relavage en lavage (A TRACER SUR ECOSOFT)				
Nom du/DM concernés:	<input type="checkbox"/> DM non démontés <input type="checkbox"/> DM non branchés <input type="checkbox"/> DM avec salissures +++				
Nom du DM salabillé:	Non conformités avec relavage manuel (NE PAS TRACER SUR ECOSOFT)				
	<input type="checkbox"/> Stock <input type="checkbox"/> Tombé par terre <input type="checkbox"/> Légèrement souillé <input type="checkbox"/> Rouillé				
Partie à remplir par le lavage					
DATE:	HEURE:				
Lavage manuel Par:	USI Modisato N°:	USI Anios N°:	US Friteuse N°:	US Bolimod N°:	Lavage N° charge:
	Par:	Par:	Par:	Par:	Par:
Retour conditionnement					
DM conforme -- Remis dans la boîte après recompo par:					Date et heure:
DM en satellite conforme -- conditionné par:					
DM non-conforme -- Retour lavage par:					

→ Analyse rétrospective sur 3 mois

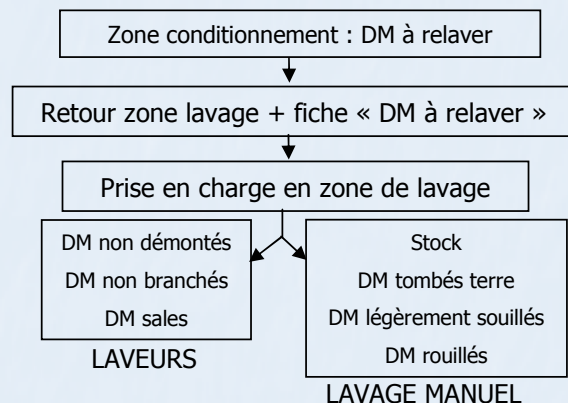


Résultats

834 DM relavés sur 3 mois : 222 relavés en lavage (27%), 403 relavés manuellement (73%)

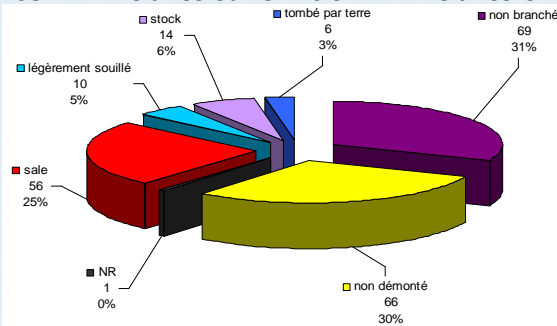

Répartition des DM relavés en lavage

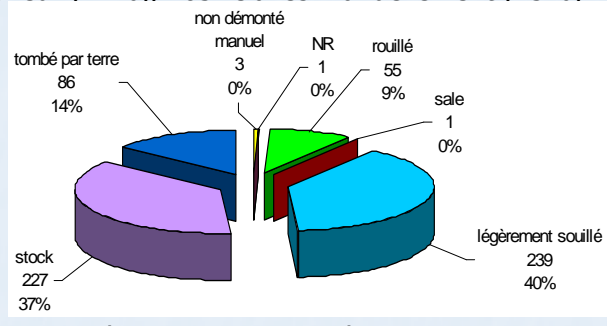

Répartition des DM relavés manuellement

Discussion

Réactualisation mode opératoire "prise en charge des DM en sortie laveurs "

- Amélioration de la prise en charge
- Homogénéisation des pratiques

↑ traçabilité, informatique des non conformités en sortie laveurs

- Amélioration du circuit
- DM non démontés ou non branchés : cibler et actualiser fiches de lavage des DM concernés

Certains DM relavés fréquemment (pinces bipolaires, barraya)

- Travail avec le bloc opératoire pour améliorer l'étape de prédésinfection

DM rouillés

- ↑ utilisation rénovateur
- Etude du nombre de DM rouillés à réaliser

Conclusion

- Homogénéisation et amélioration des pratiques
- Pistes d'amélioration du traitement des DM en collaboration avec le bloc opératoire
- Réorganisation des DM à relaver manuellement pour traçabilité informatique exhaustive
- Réévaluation à 1 an + étude de la traçabilité du lavage manuel pour les DM à relaver