



Perte de traçabilité de l'étape de stérilisation : 3 ans après combien en reste-t-il ?

P026

E.Gravier, A-L Ferrier, P.Klein, C.Dussart, N.Lonca, S.Corvaisier

Stérilisation Centrale, Hospices Civils de Lyon, 1060 rue Nicéphoe Niepce, 69 800 Saint Priest

Introduction :

Processus de stérilisation des dispositifs médicaux restérilisables (DMR) = traçabilité obligatoire


Perte de traçabilité de stérilisation (PTS) = DMR stérilisé sans que l'on puisse en établir la preuve

Objectif : Comparaison qualitative et quantitative des PTS entre deux périodes séparées de 3 ans
Validation des mesures correctives initiales

Matériel et méthode :

- Logiciel : HOPITAL MANAGER
- Périodes :
 - Période A : 2018-2019, 5 mois
 - Période B : 2021-2022, 5 mois
- Recueil : prospectif grâce au logiciel de traçabilité
- Analyse : recherche de cause pour chaque PTS

Après détection d'une PTS sur HM STE®, est-ce qu'il y a eu :
Rattrapage HM STE® par un Chef d'équipe

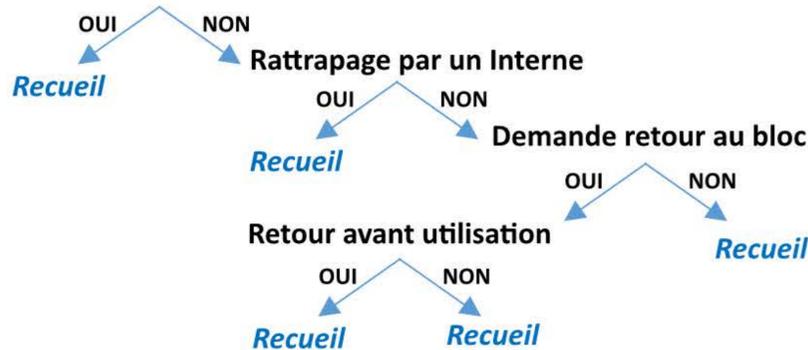

Résultats :


Période A : 1 515 PTS (0,45% de l'activité en UO)

⇒ Actions correctives 2019 :

- check-list chef d'équipe
- révision paramétrage article
- sensibilisation ...

Période B : 455 PTS (0,18% de l'activité en UO)

Rattrapage HM STE® par Chef d'équipe

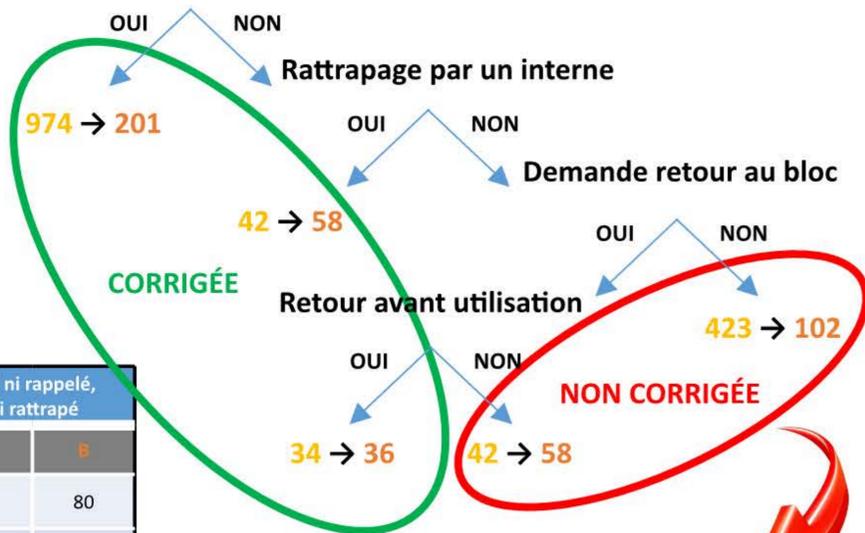

	Rattrapage Chef d'équipe		Rattrapage par internes		Retour bloc demandé		DM ni rappelé, ni rattrapé	
	A	B	A	B	A	B	A	B
Panier non scanné	762	138	25	50	19	29	247	80
Boîte non scannée	205	63	1	2	11	27	12	1
Erreur saisie manuelle	1	0	5	4	13	11	70	3
Erreur paramétrage	0	0	6	0	0	0	30	0
Changement panier *	3	0	1	1	2	9	29	8
DM sans panier **	3	0	1	0	22	12	5	0
Doublon recompo.	0	0	0	0	0	0	9	3
Autre	0	0	3	1	9	6	21	7

* panier changé physiquement mais pas informatiquement
**DM paramétré sans panier mais stérilisé dans un panier donc non informatisé

PTS non corrigées

- 30,7% (2019) vs 35,2% (2021) des PTS totales (différence Non Significative)
- de **0,14%** à **0,06%** en part d'activité UO

Diminution des PTS

- de **70%** en valeur absolue
- de **60%** en part d'activité

Mesures correctives validées

Discussion :

- ⇒ Efficacité des actions entreprises en 2019 pour réduire le nombre de PTS
- ⇒ Pas d'amélioration dans la proportion de PTS non corrigées
- ⇒ Répartition superposable des causes sur les deux périodes
- ⇒ Amélioration continue : nouvelle vidéo de formation : « Préparation paniers : cherchez l'erreur »

Conclusion :

- Poursuite du recueil journalier des PTS et validation des actions entreprises
- Analyse annuelle
- Nouvelles actions : formation, paramétrage HM STE, audit prospectif ...

